


皮膜の離型性

最大剪断応力(N/cm²)

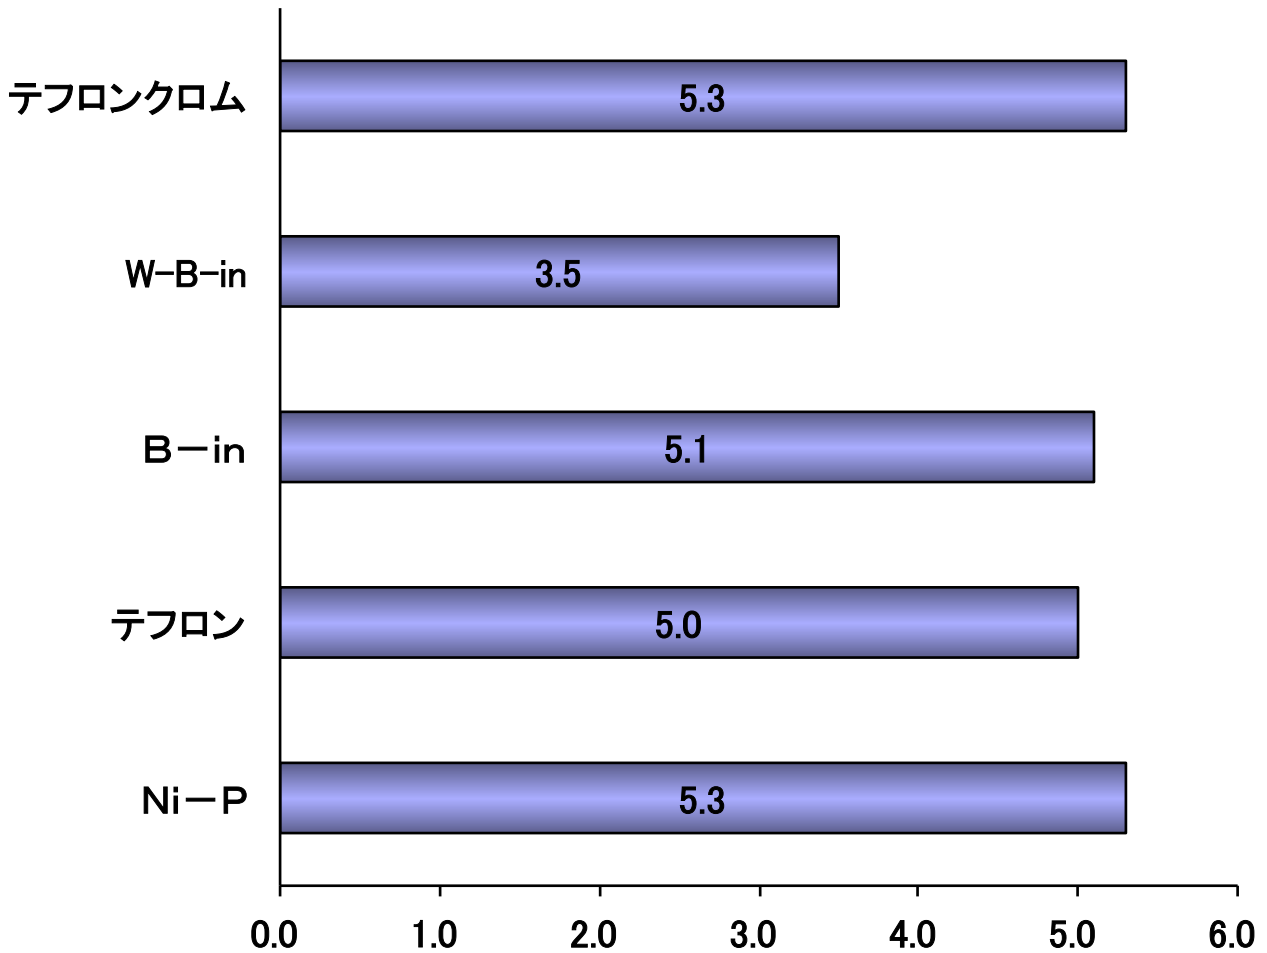

	最大剪断応力(N/cm ²)
Ni-P	5.3
テフロン	5.0
B-in	5.1
W-B-in	3.5
テフロンクロム	5.3

評価方法: 試料にニチバン製絆創膏(キープポア@A、幅15mm)を貼付し、剪断応力を付加して、剥離する際の力を測定。

貼付面積: 1.5cm x 0.9mm